

# KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA

**REF** : KBI1028

Ver 2.0

**IVD**

Enzyme Immunoassay for the quantitative determination of Daratumumab in serum, plasma and cell culture supernatant

**IVD**

For In-Vitro Diagnostic Use

**REF**

Catalog Number



Store At

**LOT**

Batch Code



Manufactured By



Biological Risk



Expiry Date



Consult Operating Instructions

*For In-Vitro Diagnostic Use Only. Purchase does not include or carry the right to resell or transfer this product either as a stand-alone product or as a component of another product. Any use of this product other than the permitted use without the express written authorization of KRISHGEN BioSystems is strictly prohibited.*



**REF** KBI1028

96 tests



**KRISHGEN BioSystems**

Unit Nos#318/319, Shah & Nahar,  
Off Dr E Moses Road, Worli, Mumbai 400018.  
Tel: 91 (22) 49198700 | Email: sales@krishgen.com  
<http://www.krishgen.com>



MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

[www.krishgen.com](http://www.krishgen.com)

<b>English Instructions</b>	...	...	...	<b>Pages 3 - 9</b>
<b>French Instructions</b>	...	...	...	<b>Pages 10 - 17</b>
<b>German Instructions</b>	...	...	...	<b>Pages 18 - 25</b>
<b>Spanish Instructions</b>	...	...	...	<b>Pages 26 - 33</b>

**Introduction:**


Daratumumab (trade name Darzalex) is an anti-cancer drug. It binds to CD38, which multiple myeloma cells overexpress. Daratumumab was originally developed by Genmab, but it is now being jointly developed by Genmab along with the Johnson & Johnson subsidiary Janssen Biotech, which acquired worldwide commercialization rights to the drug from Genmab. Daratumumab was given breakthrough therapy drug status in 2013 for multiple myeloma. It was awarded orphan drug status for multiple myeloma, diffuse large B cell lymphoma, follicular lymphoma, and mantle cell lymphoma.

**Intended Use:**

The KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA is used as an analytical tool for quantitative determination of Daratumumab in serum, plasma and cell culture supernatant.

**Principle:**

The method employs the quantitative sandwich enzyme immunoassay technique. Antibodies to Daratumumab are pre-coated onto microwells. Samples and standards are pipetted into microwells and human Daratumumab present in the sample are bound by the capture antibody. Then, a HRP (horseradish peroxidase) conjugated anti-Daratumumab antibody is pipetted and incubated. After washing microwells in order to remove any non-specific binding, the ready to use substrate solution (TMB) is added to microwells and color develops proportionally to the amount of Daratumumab in the sample. Color development is then stopped by addition of stop solution. Absorbance is measured at 450 nm.

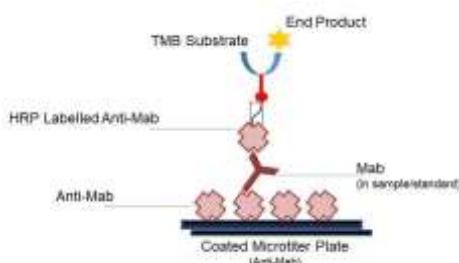**Materials Provided:**

1. Anti-Daratumumab Coated Microtiter Plate (12x8 wells) – 1 no
2. Daratumumab Standard, (0.1 ml/vial) – 0, 0.2, 0.5, 2, 5, 20, 50 and 100 µg/ml
3. Anti-Daratumumab:HRP Conjugate – 6 ml
4. Assay Diluent – 6 ml
5. Sample Diluent – 50 ml
6. Wash Buffer (20X) – 25 ml
7. TMB Substrate – 12 ml
8. Stop Solution – 12 ml
9. Instruction Manual

**Materials to be provided by the End-User:**

1. Microtiter Plate Reader able to measure absorbance at 450 nm.
2. Adjustable pipettes and multichannel pipettor to measure volumes ranging from 25µl to 1000µl
3. Deionized (DI) water
4. Wash bottle or automated microplate washer
5. Semi-Log graph paper or software for data analysis
6. Timer
7. Absorbent Paper

**Handling/Storage:**

1. All reagents should be stored at 2°C to 8°C for stability.
2. All the reagents and wash solutions should be used within 12 months from manufacturing date.

3. Before using, bring all components to room temperature (18-25°C). Upon assay completion ensure all components of the kit are returned to appropriate storage conditions.
4. The Substrate is light-sensitive and should be protected from direct sunlight or UV sources.

**Health Hazard Warnings:**

1. Reagents that contain preservatives may be harmful if ingested, inhaled or absorbed through the skin.
2. For In-Vitro Diagnostic Use Only.

**Sample Preparation and Storage:**

Blood is taken by venipuncture. Serum is separated after clotting by centrifugation. Plasma can be used, too. Lipaemic, hemolytic or contaminated samples should not be run. Repeated freezing and thawing should be avoided. If samples are to be used for several assays, initially aliquot samples and keep at - 20°C.

For Cell Culture Supernatant – If necessary, centrifuge to remove debris prior to analysis. Samples can be stored at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

**Preparation Before Use:**

Allow samples to reach room temperature prior to assay. Take care to agitate patient samples gently in order to ensure homogeneity.

Test Sample preparation - Samples have to be diluted 1:500 to 1:1000 (v/v), e.g. for 1:500 (1 µl sample + 499 µl sample diluent) prior to assay. The samples may be kept at 2 - 8°C for up to three days. Long-term storage requires -20°C.

**Reagent Preparation (all reagents should be diluted immediately prior to use):**

1. Label any aliquots made with the kit Lot No and Expiration date and store it at appropriate conditions mentioned.
2. Bring all reagents to Room temperature before use.
3. To make Wash Buffer (1X); dilute 50 ml of 20X Wash Buffer in 950 ml of DI water.

**Procedural Notes:**

1. In order to achieve good assay reproducibility and sensitivity, proper washing of the plates to remove excess un-reacted reagents is essential.
2. High Dose Hook Effect may be observed in samples with very high concentrations of Daratumumab. High Dose Hook Effect is due to excess of antibody for very high concentrations of Daratumumab present in the sample. High Dose Hook effect is most likely encountered from samples early in the purification process. If Hook Effect is possible, the samples to be assayed should be diluted with a compatible diluent. Thus if the Daratumumab concentration of the undiluted sample is less than the diluted sample, this may be indicative of the Hook Effect.
3. Avoid assay of Samples containing sodium azide ( $\text{NaN}_3$ ), as it could destroy the HRP activity resulting in under-estimation of the amount of Daratumumab.
4. It is recommended that all Standards and Samples be assayed in duplicates.
5. Maintain a repetitive timing sequence from well to well for all the steps to ensure that the incubation timings are same for each well.
6. If the Substrate has a distinct blue color prior to use it may have been contaminated and use of such substrate can lead to compromisation of the sensitivity of the assay.
7. The plates should be read within 30 minutes after adding the Stop Solution.
8. Make a work list in order to identify the location of Standards and Samples.

**Assay Procedure:**

1. It is strongly recommended that all Controls and Samples be run in duplicates or triplicates. A standard curve is required for each assay. All steps must be performed at 37°C
2. Pipette out **50 µl** of **Assay Diluent** in each well.

3. Add **100 µl** of **Standards or Samples** into the respective wells.
4. Cover the plate and incubate for 60 minutes at 37°C
5. Aspirate and wash plate 4 times with **Wash Buffer (1X)** and blot residual buffer by firmly tapping plate upside down on absorbent paper. Wipe of any liquid from the bottom outside of the microtiter wells as any residue can interfere in the reading step.
6. Pipette without delay in the same order **50 µl** of **Anti-Daratumumab: HRP Conjugate** into each well.
7. Cover the plate and incubate for 60 minutes at 37°C
8. Aspirate and wash plate 4 times with **Wash Buffer (1X)** and blot residual buffer by firmly tapping plate upside down on absorbent paper. Wipe of any liquid from the bottom outside of the microtiter wells as any residue can interfere in the reading step.
9. Add **100 µl** of **TMB Substrate** in each well.
10. Incubate the plate at 37°C for 30 minutes in dark. DO NOT SHAKE or else it may result in higher backgrounds and worse precision. Positive wells should turn bluish in color.
11. Pipette out **100 µl** of **Stop Solution**. Wells should turn from blue to yellow in color.
12. Read the absorbance at 450 nm with a microplate reader.

#### **Calculation of Results:**

Determine the Mean Absorbance for each set of duplicate or triplicate Standards and Samples. Using Semi-Log graph paper, plot the average value (absorbance 450nm) of each standard on the Y-axis versus the corresponding concentration of the standards on the X-axis. Draw the best fit curve through the standard points. To determine the unknown Daratumumab concentrations, find the unknown's Mean Absorbance value on the Y-axis and draw a horizontal line to the standard curve. At the point of intersection, draw a vertical line to the X-axis and read the Daratumumab Concentration. If samples were diluted, multiply by the appropriate dilution factor. Software which is able to generate a cubic spline curve-fit is best recommended for automated results.

#### **Note:**

It is recommended to repeat the assay at a different dilution factor in the following cases:

- If the sample absorbance value is below the first standard.
- If the absorbance value is equivalent or higher than the 100 µg/ml standard.

#### **Quality Control:**

It is recommended that for each laboratory assay appropriate quality control samples in each run to be used to ensure that all reagents and procedures are correct.

#### **Performance Characteristics of the Kit:**

This kit has been validated as per EMA/FDA guidelines in line with ICH Code for Harmonization of Biological Assays.

#### **Sensitivity:**

**Limit Of Detection:** It is defined as the lowest detectable concentration corresponding to a signal of Mean of '0' standard plus 2\* SD.

10 replicates of '0' standards were evaluated and the LOD was found to be less than 0.2µg/ml

#### **Linearity:**

Standards provided in the kit will be used for measuring the linearity range of Daratumumab present in matrix.

#### **Precision:**

Precision is defined as the percent coefficient of variation (%CV) i.e. standard deviation divided by the mean and multiplied by 100. Assay precision was determined by both intra (n=5 assays) and inter assay (n=5 assays) reproducibility on two pools with low (0.2 µg/ml), medium (5 µg/ml) and high (100 µg/ml) concentrations. While actual precision may vary from laboratory to laboratory and technician to technician, it is recommended that all operators achieve precision below these design goals before reporting results.

Pool	Intra Assay %CV	Inter Assay %CV
Low	<10%	<10%
Medium	<5%	<5%
High	<5%	<5%

### Limitations of Method

Healthy individuals should be tested negative by the Daratumumab. Any clinical diagnosis should not be based on the results of in vitro diagnostic methods alone. Physicians are suggested to consider all clinical and laboratory findings possible to state a diagnosis.

### Safety Precautions:

- **This kit is for in vitro use only.** Follow the working instructions carefully.
- The expiration dates stated on the kit are to be observed. The same relates to the stability stated for reagents
- Do not use or mix reagents from different lots.
- Do not use reagents from other manufacturers.
- Avoid time shift during pipetting of reagents.
- All reagents should be kept in the original shipping container.
- Some of the reagents contain small amount of sodium azide (< 0.1 % w/w) as preservative. They must not be swallowed or allowed to come into contact with skin or mucosa.
- Source materials maybe derived from human body fluids or organs used in the preparation of this kit were tested and found negative for HBsAg and HIV as well as for HCV antibodies. However, no known test guarantees the absence of such viral agents. Therefore, handle all components and all patient samples as if potentially hazardous.
- Since the kit contains potentially hazardous materials, the following precautions should be observed
  - Do not smoke, eat or drink while handling kit material
  - Always use protective gloves
  - Never pipette material by mouth
  - Wipe up spills promptly, washing the affected surface thoroughly with a decontaminant.
- In any case GLP should be applied with all general and individual regulations to the use of this kit.



### References:

Pharmacokinetics of Daratumumab Following Intravenous Infusion in Relapsed or Refractory Multiple Myeloma After Prior Proteasome Inhibitor and Immunomodulatory Drug Treatment...Pamela L. Clemens,Xiaoyu Yan, Henk M. Lokhorst,Sagar Lonial,Nedjad Losic,Imran Khan,Richard Jansson,Tahamtan Ahmadi,Kristen Lantz,Honghui Zhou,1 Thomas Puchalski, and Xu Steven Xu...Clin Pharmacokinet...2017...Springer

Daratumumab, a CD38 Monoclonal Antibody in Patients with Multiple Myeloma - Data From a Dose-Escalation Phase I/II Study...Torben Plesner, Henk Lokhorst, Peter Gimsing, Hareth Nahi, Steen Lisby and Paul G. Richardson...Blood...2012...American Society of Hematology

Daratumumab, a Novel Therapeutic Human CD38 Monoclonal Antibody, Induces Killing of Multiple Myeloma and Other Hematological Tumors...Michel de Weers, Yu-Tzu Tai, Michael S. van der Veer, Joost M. Bakker, Tom Vink, Daniëlle C. H. Jacobs, Lukas A. Oomen, Matthias Peipp, Thomas Valerius, Jerry W. Slootstra, Tuna Mutis, Wim K. Bleeker, Kenneth C. Anderson, Henk M. Lokhorst, Jan G. J. van de Winkel and Paul W. H. I. Parren... J Immunol...2011... American Association of Immunologists

Daratumumab depletes CD38+ immune regulatory cells, promotes T-cell expansion, and skews T-cell repertoire in multiple myeloma Jakub Krejcik, Tineke Casneuf, Inger S. Nijhof, Bie Verbist, Jaime Bald, Torben Plesner, Khaja Syed, Kevin Liu, Niels W. C. J. van de Donk, Brendan M. Weiss, Tahamtan Ahmadi, Henk M. Lokhorst, Tuna Mutis and A. Kate Sasser...Blood...2016...American Society of Hematology

Direct in Vitro Comparison of Daratumumab with Surrogate Analogs of CD38 Antibodies MOR03087, SAR650984 and Ab79

Jeroen Lammerts van Bueren, Danielle Jakobs, Niels Kaldenhoven, Marcel Roza, Sanne Hiddingh, Joyce Meesters, Marleen Voorhorst, Elke Gresnigt, Luus Wiegman, Antonio Ortiz Buijsse, Grietje Andringa, Marije B. Overdijk, Parul Doshi, Kate Sasser, Michel de Weers and Paul W.H.I. Parren...Blood...2014...Americal Society of Hematology


Daratumumab for the treatment of multiple myeloma...Touzeau C, Moreau P... Expert Opin Biol Ther...2017...Taylor & Francis

## SCHEMATIC ASSAY PROCEDURE

1. Remove all components, 30 minutes before adding into the assay plate.



2. Avoid repeated cool-thaw of the components as there will be a loss of activity and this can affect the results.

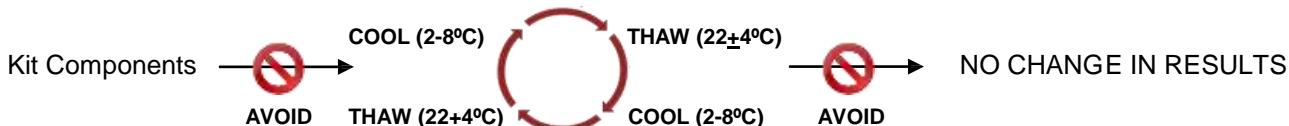

3. Pipette **50 µl Assay Diluent** into each well.

4. Pipette **100 µl Standards / Samples** into the respective wells.

5. Cover plate and incubate for at 37°C.

6. Aspirate and wash wells 4 times with **Wash Buffer (1X)**.

7. Pipette **50 µl Anti Daratumumab:HRP** into each well.

8. Cover plate and incubate for at 37°C.

9. Aspirate and wash wells 4 times with **Wash Buffer (1X)**.

10. Pipette **100 µl TMB Substrate** into each well.

11. Cover plate and incubate for at 37°C.

12. Pipette **100 µl Stop Solution** into each well.

13. Read absorbance at 450nm with a microplate reader within of stopping reaction.

**Typical Example of a Work List**

Well #	Contents	Absorbance at 450nm	Mean Absorbance	ng/ml Daratumumab equivalent
1A 2A	zero std zero std			
1B 2B	0.2 µg/ml 0.2 µg/ml			
1C 2C	0.5 µg/ml 0.5 µg/ml			
1D 2D	2 µg/ml 2 µg/ml			
1E 2E	5 µg/ml 5 µg/ml			
1F 2F	20 µg/ml 20 µg/ml			
1G 2G	50 µg/ml 50 µg/ml			
1H 2H	100 µg/ml 100 µg/ml			
3A 4A	Sample			
3B 4B	Sample			

**LIMITED WARRANTY**

Krishgen Biosystems does not warrant against damages or defects arising in shipping or handling, or out of accident or improper or abnormal use of the Products; against defects in products or components not manufactured by Krishgen Biosystems, or against damages resulting from such non-Krishgen Biosystems made products or components. Krishgen Biosystems passes on to customer the warranty it received (if any) from the maker thereof of such non Krishgen made products or components. This warranty also does not apply to Products to which changes or modifications have been made or attempted by persons other than pursuant to written authorization by Krishgen Biosystems.

**THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE.** The sole and exclusive obligation of Krishgen Biosystems shall be to repair or replace the defective Products in the manner and for the period provided above. Krishgen Biosystems shall not have any other obligation with respect to the Products or any part thereof, whether based on contract, tort, and strict liability or otherwise. Under no circumstances, whether based on this Limited Warranty or otherwise, shall Krishgen Biosystems be liable for incidental, special, or consequential damages.

This Limited Warranty states the entire obligation of Krishgen Biosystems with respect to the Products. If any part of this Limited Warranty is determined to be void or illegal, the remainder shall remain in full force and effect.

Krishgen Biosystems. 2018

**THANK YOU FOR USING KRISHGEN PRODUCT!**

# KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA

**REF** : KBI1028

Ver 2.0

**IVD**

Dosage immuno-enzymatique pour la détermination quantitative de l'Daratumumab dans le surnageant de cultures de sérum, de plasma et de cellules

<b>IVD</b>	Pour l'usage Diagnostic In Vitro	<b>REF</b>	Numéro de catalogue
	Conserver à la	<b>LOT</b>	Code du lot
	Fabriqué par		Risque biologique
	Date d'Expiration		Consulter le mode d'emploi

Réserve à l'usage Diagnostique In Vitro. L'achat n'inclut ni ne confère le droit de revendre ou de transférer ce produit, en tant que produit autonome ou en tant que composant d'un autre produit. Toute utilisation de ce produit autre que celle autorisée sans l'autorisation écrite expresse de KRISHGEN BioSystems est strictement interdite.



**REF**

KBI1028



96 tests



**KRISHGEN BioSystems**

Unit Nos#318/319, Shah & Nahar,  
Off Dr E Moses Road, Worli, Mumbai 400018.  
Tel: 91 (22) 49198700 | Email: sales@krishgen.com  
<http://www.krishgen.com>



MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

**Introduction:**


Le Daratumumab (nom commercial Darzalex) est un médicament anticancéreux. Il se lie à CD38, surexprimant les cellules de myélome multiple. Le Daratumumab a été développé à l'origine par Genmab, mais il est maintenant développé conjointement par Genmab et la filiale de Johnson & Johnson, Janssen Biotech, qui a acquis les droits de commercialisation mondiaux de ce médicament auprès de Genmab. Il a obtenu le statut de médicament orphelin pour le myélome multiple, le lymphome diffus à grandes cellules B, le lymphome folliculaire et le lymphome à cellules du manteau.

**Utilisation prévue:**

Le test KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA est utilisé comme outil d'analyse pour la détermination quantitative de l'Daratumumab dans le surnageant de cultures de sérum, de plasma et de cellules.

**Principe:**

Le procédé utilise la technique de dosage immuno-enzymatique en sandwich quantitative. Les anticorps anti-Daratumumab sont pré-endoits sur des micropuits. Les échantillons et les standards sont introduits à la pipette dans des micropuits et l'Daratumumab humain présent dans l'échantillon est lié à l'anticorps de capture. Ensuite, un anticorps anti-Daratumumab conjugué à la HRP (peroxydase de raifort) est pipeté et incubé. Après avoir lavé les micropuits pour éliminer toute liaison non spécifique, la solution de substrat prête à l'emploi (TMB) est ajoutée aux micropuits et la couleur se développe proportionnellement à la quantité d'Daratumumab présente dans l'échantillon. Le développement de la couleur est ensuite arrêté par addition de solution d'arrêt. L'absorbance est mesurée à 450 nm.

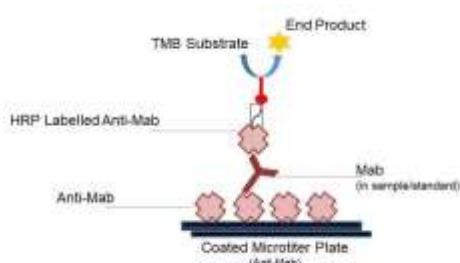**Matériaux fournis:**

1. Plaque de microtitration enrobée anti-Daratumumab (12 x 8 puits) - 1
2. Daratumumab Standard, (0,1 ml / flacon) - 0, 0,2, 0,5, 2, 5, 20, 50 et 100 µg/ml
3. Anti-Daratumumab: Conjugué HRP - 6 ml
4. Diluant de dosage - 6 ml
5. Diluant d'échantillon - 50 ml
6. Tampon de lavage (20X) - 25 ml
7. Substrat TMB - 12 ml
8. Solution d'arrêt - 12 ml
9. Manuel d'instructions

**Matériel à fournir par l'utilisateur final:**

1. Lecteur de microplaques capable de mesurer l'absorbance à 450 nm.
2. Pipettes réglables et pipettes multicanaux pour mesurer des volumes allant de 25 µl à 1000 µl
3. Eau déminéralisée (DI)
4. Laver le flacon ou le lave-linge automatique
5. Papier graphique semi-log ou logiciel pour l'analyse de données
6. Minuterie
7. Papier absorbant

**Traitement / Conservation:**

1. Tous les réactifs doivent être conservés entre 2°C et 8°C pour la stabilité.

2. Tous les réactifs et solutions de lavage doivent être utilisés dans les 12 mois suivant la date de fabrication.
3. Avant utilisation, amener tous les composants à la température ambiante (18-25°C). Une fois le test terminé, assurez-vous que tous les composants du kit sont remis dans des conditions de conservations appropriées.
4. Le substrat est sensible à la lumière et doit être protégé de la lumière directe du soleil ou des sources UV.

**Avertissements de danger pour la santé:**

1. Les réactifs contenant des conservateurs peuvent être nocifs s'ils sont ingérés, inhalés ou absorbés par la peau.
2. Réservé à l'usage diagnostique in vitro.

**Préparation et conservation des échantillons:**

Le sang est prélevé par ponction veineuse. Le sérum est séparé après coagulation par centrifugation. Le plasma peut aussi être utilisé. Les échantillons lipémiques, hémolytiques ou contaminés ne doivent pas être analysés. Les congélations et décongélations répétées doivent être évitées. Si des échantillons doivent être utilisés pour plusieurs tests, commencez par des aliquotes et maintenez-les à -20°C.

Pour le surnageant de culture cellulaire - Si nécessaire, centrifuger pour éliminer les débris avant l'analyse. Les échantillons peuvent être conservés à -20°C ou -80°C. Évitez les cycles répétés de congélation / décongélation.

**Préparation avant utilisation:**

Laisser les échantillons atteindre la température ambiante avant le dosage. Veillez à agiter doucement les échantillons de patients afin d'assurer leur homogénéité.

Préparation des échantillons de test - Les échantillons doivent être dilués au 1 :500 à 1 :1000e (v/v), par ex. Pour 1 :500 (1 µl d'échantillon + 499 µl de diluant pour échantillon) avant le dosage. Les échantillons peuvent être conservés entre 2 et 8°C pendant trois jours maximum. La conservation à long terme nécessite -20°C.

**Préparation des réactifs (tous les réactifs doivent être dilués immédiatement avant utilisation):**

1. Étiquetez toutes les parties aliquotes faites avec le numéro de lot et la date de péremption du kit et conservez-la dans les conditions appropriées mentionnées.
2. Amenez tous les réactifs à la température ambiante avant utilisation.
3. Préparer le tampon de lavage (1X); diluer 50 ml de tampon de lavage 20X dans 950 ml d'eau désionisée.

**Notes de procédure:**

1. Pour obtenir une bonne reproductibilité et sensibilité du test, il est essentiel de bien laver les plaques afin d'enlever les réactifs en excès qui n'ont pas réagi.
2. Des effets de crochet à forte dose peuvent être observés dans des échantillons contenant de très fortes concentrations d'Daratumumab. L'effet crochet à haute dose est dû à un excès d'anticorps pour de très fortes concentrations d'Daratumumab présent dans l'échantillon. L'effet Crochet à forte dose est très probablement rencontré dans les échantillons au début du processus de purification. Si l'effet crochet est possible, les échantillons à analyser doivent être dilués avec un diluant compatible. Ainsi, si la concentration en Daratumumab de l'échantillon non dilué est inférieure à celle de l'échantillon dilué, cela peut indiquer l'effet Crochet.
3. Évitez de doser des échantillons contenant de l'azide de sodium ( $\text{NaN}_3$ ), car cela pourrait détruire l'activité de la HRP et entraîner une sous-estimation de la quantité d'Daratumumab.
4. Il est recommandé que tous les étalons et échantillons soient analysés en double.
5. Maintenez une séquence de synchronisation répétitive de puits en puits pour toutes les étapes afin de vous assurer que les périodes d'incubation sont les mêmes pour chaque puits.
6. Si le substrat a une couleur bleue distincte avant utilisation, il peut avoir été contaminé et l'utilisation de ce substrat peut compromettre la sensibilité du test.
7. Les plaques doivent être lues dans les 30 minutes qui suivent l'ajout de la solution d'arrêt.
8. Faites une liste de travail afin d'identifier l'emplacement des normes et des échantillons.

**Procédure de dosage:**

1. Il est fortement recommandé que tous les contrôles et échantillons soient exécutés en double ou en triple. Une courbe standard est requise pour chaque test. Toutes les étapes doivent être effectuées à 37°C.
2. Pipeter **50 µl de diluant de dosage** dans chaque puits.
3. Ajouter **100 µl d'étalons ou d'échantillons** dans les puits respectifs.
4. Couvrir la plaque et incuber pendant 60 minutes à 37°C.
5. Aspirer et laver la plaque 4 fois avec le **tampon de lavage (1X)** et éponger le tampon résiduel en tapotant fermement la plaque à l'envers sur du papier absorbant. Essuyez tout liquide du fond à l'extérieur des puits de la microtitration, car tout résidu peut interférer dans l'étape de lecture.
6. Pipeter sans délai, dans le même ordre, **50 µl de conjugué Anti-Daratumumab: HRP** dans chaque puits.
7. Couvrir la plaque et incuber pendant 60 minutes à 37°C.
8. Aspirer et laver la plaque 4 fois avec le **tampon de lavage (1X)** et éponger le tampon résiduel en tapotant fermement la plaque à l'envers sur du papier absorbant. Essuyez tout liquide du fond à l'extérieur des puits de la microtitration, car tout résidu peut interférer dans l'étape de lecture.
9. Ajouter **100 µl de substrat TMB** dans chaque puits.
10. Incuber la plaque à 37°C pendant 30 minutes dans l'obscurité. NE PAS AGITER, sinon cela pourrait entraîner des arrière-plans plus grands et une moins bonne précision. Les puits positifs doivent virer au bleuâtre.
11. Pipeter **100 µl de solution d'arrêt**. Les puits devraient passer du bleu au jaune.
12. Lire l'absorbance à 450 nm avec un lecteur de microplaques.

**Calcul des résultats:**

Déterminez l'absorbance moyenne pour chaque ensemble d'étalons et d'échantillons en double ou en triple. En utilisant du papier quadrillé Semi-Log, tracez la valeur moyenne (absorbance 450 nm) de chaque standard sur l'axe des Y par rapport à la concentration correspondante des standards sur l'axe des X. Tracez la courbe de meilleur ajustement à travers les points standard. Pour déterminer les concentrations inconnues d'Daratumumab, recherchez la valeur d'absorbance moyenne de l'inconnue sur l'axe des Y et tracez une ligne horizontale vers la courbe standard. Au point d'intersection, tracez une ligne verticale sur l'axe des X et lisez la concentration en Daratumumab. Si les échantillons ont été dilués, multiplier par le facteur de dilution approprié. Un logiciel capable de générer une courbe de spline cubique est le mieux recommandé pour obtenir des résultats automatisés.

**Remarque:**

Il est recommandé de répéter le test à un facteur de dilution différent dans les cas suivants:

- Si la valeur de l'absorbance de l'échantillon est inférieure au premier standard.
- Si la valeur d'absorbance est équivalente ou supérieure au standard de 100 µg/ml.

**Contrôle de qualité:**

Il est recommandé que, pour chaque test de laboratoire, des échantillons de contrôle de la qualité appropriés soient utilisés lors de chaque analyse pour garantir que tous les réactifs et procédures sont corrects.

**Caractéristiques de performance du kit:**

Ce kit a été validé conformément aux directives EMA / FDA et au code d'harmonisation des tests biologiques de l'ICH.

#### Sensibilité:

**Limite de détection:** Elle est définie comme la concentration détectable la plus basse correspondant à un signal de moyenne égale à «0» standard plus 2 \* SD.

10 répétitions d'étalons «0» ont été évaluées et la limite de détection était inférieure à 0,2 µg / ml

#### Linéarité:

Les normes fournies dans le kit seront utilisées pour mesurer la plage de linéarité de l'Daratumumab présent dans la matrice.

#### Précision:

La précision est définie comme le coefficient de variation en pourcentage (% CV), c'est-à-dire l'écart type divisé par la moyenne et multiplié par 100. La précision du test a été déterminée à la fois par la reproductibilité intra ( $n = 5$  tests) et entre les tests ( $n = 5$  tests) sur deux pools (mares) avec des concentrations faibles (0,2 µg/ml), moyennes (5 µg/ml) et élevées (100 µg/ml). Bien que la précision réelle puisse varier d'un laboratoire à l'autre et d'un technicien à l'autre, il est recommandé à tous les opérateurs d'atteindre une précision inférieure à ces objectifs de conception avant de communiquer les résultats.

Pool	Test Intra %CV	Test Inter %CV
Faible	<10%	<10%
Moyen	<5%	<5%
Haute	<5%	<5%

#### Limites de la méthode

Les personnes en bonne santé doivent être testées négatives par l'Daratumumab. Tout diagnostic clinique ne doit pas être basé sur les résultats de méthodes de diagnostic in vitro uniquement. Les médecins sont invités à prendre en compte toutes les découvertes cliniques et de laboratoire permettant d'établir un diagnostic.

#### Précautions de sécurité:

- **Ce kit est uniquement destiné à une utilisation in vitro.** Suivez attentivement les instructions de travail.
- Les dates de péremption indiquées sur le kit doivent être respectées. La même chose concerne la stabilité indiquée pour les réactifs.
- Ne pas utiliser ou mélanger les réactifs de lots différents.
- N'utilisez pas de réactifs d'autres fabricants.
- Évitez les décalages horaires lors du pipetage des réactifs.
- Tous les réactifs doivent être conservés dans le conteneur d'expédition original.
- Certains réactifs contiennent une petite quantité d'azoture de sodium (<0,1% p/p) comme conservateur. Ils ne doivent pas être avalés ou autorisés à entrer en contact avec la peau ou les muqueuses.
- Les matériaux sources pouvant provenir de fluides corporels humains ou d'organes utilisés dans la préparation de ce kit ont été testés et se sont révélés négatifs pour HBsAg et VIH ainsi que pour les anticorps anti-VHC. Cependant, aucun test connu ne garantit l'absence de tels agents vitaux. Par conséquent, manipulez tous les composants et tous les échantillons de patients comme s'ils étaient potentiellement dangereux.
- Étant donné que le kit contient des matériaux potentiellement dangereux, les précautions suivantes doivent être observées :
  - Ne pas fumer, manger ou boire pendant la manipulation du matériel
  - Toujours utiliser des gants de protection
  - Ne jamais pipeter le produit à la bouche
  - Essuyez rapidement les éclaboussures en lavant soigneusement la surface affectée avec un décontaminant.
  - Dans tous les cas, les BPL doivent être appliqués à toutes les réglementations générales et individuelles relatives à l'utilisation de ce kit.



#### Références:

Pharmacocinétique de Daratumumab suite à une perfusion intraveineuse dans un myélome multiple rechute ou réfractaire après un inhibiteur protéasome préalable et un traitement médicamenteux immunomodulateurs... Pamela L. Clemens, Xiaoyu Yan, Henk M. Lokhorst, Sagar Lonial, Nedjad Losic, Imran Khan, Richard Jansson, tamassi Ahmadi, Kristen Lantz, Honghui Zhou, 1 Thomas Puchalski, et Xu Steven Xu... Clin Pharmacokinet... 2017... Springer

Daratumumab, un anticorps monoclonal CD38 chez les patients atteints de myélome multiple-données d'une étude de phase I/II de la dose-escalade... Torben Plesner, Henk Lokhorst, Peter Gimsing, Hareth Nahi, Steen Lisby et Paul G. Richardson... Sang... 2012... Société américaine d'hématologie

Daratumumab, un nouvel anticorps monoclonal CD38 humain thérapeutique, induit l'assassinat du myélome multiple et d'autres tumeurs hématologiques... Michel de weers, Yu-Tzu Tai, Michael S. van der Veer, Joost M. Bakker, Tom Vink, Daniëlle C. H. Jacobs, Lukas A. Oomen, Matthias prudent, Thomas Valerius, Jerry W. Slootstra, thon Mutis, Wim K. Bleeker, Kenneth C. Anderson, Henk M. Lokhorst, Jan G. J. van de Winkel et Paul W. H. I. Parren... J immuno... 2011... Association américaine de immunologistes

Daratumumab appauvrit les cellules régulatrices CD38 + immunitaires, favorise l'expansion des lymphocytes T et incline le répertoire des lymphocytes T dans le myélome multiple  
Jakub Krejcik, Tineke Casneuf, Inger S. Nijhof, BIE Verbist, Jaime Bald, Torben Plesner, Khaja Syed, Kevin Liu, Niels W. C. J. van de Donk, Brendan M. Weiss, tamassi Ahmadi, Henk M. Lokhorst, thon Mutis et A. Kate Sasser... Sang... 2016... Société américaine d'hématologie

Comparaison directe in vitro de Daratumumab avec des analogues de substitution d'anticorps CD38 MOR03087, SAR650984 et Ab79 Jeroen Lammerts van Bueren, Danielle Jakobs, Niels Kaldenhoven, Marcel Roza, seye Hiddingh, Joyce Moreau, Marleen Voorhorst, Elke Gresnigt, Iuus Wiegman, Antonio Ortiz Buijsse, Grietje Andringa, Marije B. surdijk, de la weers et Paul W.H.I. Parren... Sang... 2014... Société américaine d'hématologie

Daratumumab pour le traitement du myélome multiple... Touzeau C, Moreau P... Expert Opin Biol ther.... 2017... Taylor & Francis

## MODE OPERATOIRE SCHÉMATIQUE

1. Retirez tous les composants, 30 minutes avant de les ajouter à la plaque de dosage.



2. Évitez les cycles répétés de décongélation à froid des composants car il y aurait une perte d'activité et cela pourrait affecter les résultats.




3. Pipetter 50 µl diluant de dosage dans chaque puit.



4. Pipeter 100 µl de standards / échantillons dans les puits respectifs.



5. Couvrir la plaque et Incuber pendant 60 min à 37°C.



6. Aspirer et laver les puits 4 fois avec le Tampon de Lavage (1X).



7. Pipetter 50 µl Anti Daratumumab:HRP dans chaque puits.




8. Couvrir la plaque et Incuber pendant 60 min à 37°C.



9. Aspirer et laver les puits 4 fois avec le Tampon de Lavage (1X).



10. Pipetter 100 µl Substrat TMB dans chaque puits.



11. Couvrir la plaque et Incuber pendant 30 min à 37°C.



12. Pipetter 100 µl de Solution d'arrêt dans chaque puits.



13. Lire l'absorbance à 450 nm avec un lecteur dans les 30 min de la réaction d'arrêt.

**Exemple typique d'une liste de travail**

Puits#	Contenu	Absorbance à 450 nm	Absorbance moyenne	équivalent d'Daratumumab ng/ml
1A 2A	zero std zero std			
1B 2B	0,2 µg/ml 0,2 µg/ml			
1C 2C	0,5 µg/ml 0,5 µg/ml			
1D 2D	2 µg/ml 2 µg/ml			
1E 2E	5 µg/ml 5 µg/ml			
1F 2F	20 µg/ml 20 µg/ml			
1G 2G	50 µg/ml 50 µg/ml			
1H 2H	100 µg/ml 100 µg/ml			
3A 4A	Échantillon			
3B 4B	Échantillon			

**GARANTIE LIMITÉE**

Krishgen Biosystems ne garantit pas les dommages ou défauts résultant de l'expédition ou de la manutention, ou résultant d'un accident ou d'une utilisation inappropriée ou anormale des Produits; contre les défauts des produits ou composants non fabriqués par Krishgen Biosystems, ou contre les dommages résultant de tels produits ou composants non fabriqués par Krishgen Biosystems. Krishgen Biosystems transmet au client la garantie (le cas échéant) reçue de son fabricant de tels produits ou composants non fabriqués par Krishgen. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux produits sur lesquels des modifications ont été apportées ou tentées par des personnes autres que celles soumises à l'autorisation écrite de Krishgen Biosystems.

**CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE.** La seule et unique obligation de Krishgen Biosystems est de réparer ou de remplacer les produits défectueux de la manière et pour la période indiquées ci-dessus. Krishgen Biosystems n'a aucune autre obligation à l'égard des produits, en tout ou en partie, que ce soit sur la base d'un contrat, d'une responsabilité délictuelle, de la responsabilité sans faute ou autrement. En aucun cas, que ce soit sur la base de cette garantie limitée ou autrement, Krishgen Biosystems ne pourra être tenu responsable des dommages accessoires, spéciaux ou consécutifs.

Cette garantie limitée stipule l'entièvre obligation de Krishgen Biosystems en ce qui concerne les produits. Si une partie de cette garantie limitée est considérée comme nulle ou illégale, le reste restera en vigueur et de plein effet.

Biosystèmes de Krishgen. 2018

**MERCI D'UTILISER LE PRODUIT KRISHGEN!**

# KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA

**REF** : KBI1028

Ver 2.0

**IVD**

Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von  
Daratumumab in Serum, Plasma und Zellkulturüberstand

<b>IVD</b>	Für die In-Vitro-Diagnostik	<b>REF</b>	Katalognummer
	Speichern bei		
		<b>LOT</b>	Batch-Code
	Hergestellt von		Biologisches Risiko
	Verfallsdatum		Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung

Nur zur In-Vitro-Diagnostik. Der Kauf beinhaltet nicht das Recht, dieses Produkt weiterzuverkaufen oder zu übertragen, weder als eigenständiges Produkt noch als Bestandteil eines anderen Produkts. Jegliche Verwendung dieses Produkts außer der erlaubten Verwendung ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von KRISHGEN BioSystems ist strengstens untersagt.



**REF** KBI1028

96 tests



**KRISHGEN BioSystems**

Unit Nos#318/319, Shah & Nahar,  
Off Dr E Moses Road, Worli, Mumbai 400018.  
Tel: 91 (22) 49198700 | Email: sales@krishgen.com  
<http://www.krishgen.com>



MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

**Einführung:**


Daratumumab (Handelsname Darzalex) ist ein Anti-Krebs-Medikament. Es bindet an CD38, welches multiple Myelomzellen überexprimiert. Daratumumab wurde ursprünglich von Genmab entwickelt, wird aber nun gemeinsam von Genmab zusammen mit der Johnson & Johnson-Tochter Janssen Biotech entwickelt, die weltweite Vermarktungsrechte an dem Medikament von Genmab erworben hat. Daratumumab erhielt 2013 einen Durchbruchstherapie-Status für das multiple Myelom. Es erhielt den Orphan-Drug-Status für multiples Myelom, diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom, folliculäres Lymphom und Mantelzell-Lymphom.

**Verwendungszweck:**

Der KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA wird als analytisches Werkzeug zur quantitativen Bestimmung von Daratumumab in Serum, Plasma und Zellkulturüberstand verwendet.

**Prinzip:**

Das Verfahren verwendet die quantitative Sandwich-Enzym-Immunoassay-Technik. Antikörper gegen Daratumumab sind auf Mikrowells vorbeschichtet. Proben und Standards werden in Mikrowells pipettiert und menschliches Daratumumab, das in der Probe vorhanden ist, wird durch den Fängerantikörper gebunden. Dann wird ein mit HRP (Meerrettichperoxidase) konjugierter Anti-Daratumumab-Antikörper pipettiert und inkubiert. Nach dem Waschen der Mikroküvetten, um jegliche unspezifische Bindung zu entfernen, wird die gebrauchsfertige Substratlösung (TMB) in die Mikrokavitäten gegeben und die Farbe entwickelt sich proportional zur Menge an Daratumumab in der Probe. Die Farbentwicklung wird dann durch Zugabe von Stopplösung gestoppt. Die Extinktion wird bei 450 nm gemessen.

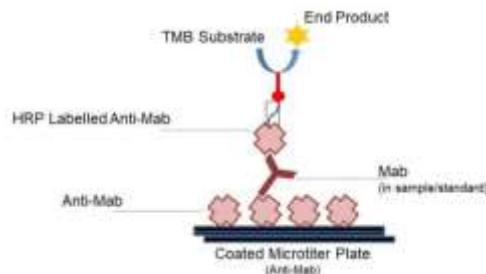**Materialien zur Verfügung gestellt:**

1. Anti-Daratumumab-beschichtete Mikrotiterplatte (12x8 Wells) - 1 Stück
2. Daratumumab Standard, (0,1 ml / Fläschchen) - 0, 0,2, 0,5, 2, 5, 20, 50 und 100 µg/ml
3. Anti-Daratumumab: HRP-Konjugat - 6 ml
4. Testverdünnungsmittel - 6 ml
5. Probenverdünnungsmittel - 50 ml
6. Waschpuffer (20X) - 25 ml
7. TMB Substrat - 12 ml
8. Stopplösung - 12 ml
9. Bedienungsanleitung

**Vom Endnutzer bereitzustellende Materialien:**

1. Mikrotiterplattenleser zur Messung der Absorption bei 450 nm.
2. Einstellbare Pipetten und Mehrkanalpipetten zur Messung von Volumina zwischen 25µl und 1000µl
3. Deionisiertes (DI) Wasser
4. Waschflasche oder automatische Mikrotiterplattenwaschmaschine
5. Semi-Log-Papier oder Software für die Datenanalyse
6. Timer
7. Absorbierendes Papier

**Handhabung / Lagerung:**

1. Alle Reagenzien sollten zur Stabilisierung bei 2°C bis 8°C gelagert werden.

2. Alle Reagenzien und Waschlösungen sollten innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verwendet werden.
3. Bringen Sie alle Komponenten vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur (18-25°C). Stellen Sie nach Abschluss des Tests sicher, dass alle Komponenten des Kits zu geeigneten Lagerungsbedingungen zurückgebracht werden.
4. Das Substrat ist lichtempfindlich und sollte vor direkter Sonneneinstrahlung oder UV-Strahlen geschützt werden.

#### **Warnungen vor Gesundheitsgefahren:**

1. Reagenzien, die Konservierungsstoffe enthalten, können schädlich sein, wenn sie über die Haut aufgenommen, inhaliert oder absorbiert werden.
  2. Nur für die In-Vitro-Diagnostik.
- 

#### **Probenvorbereitung und Lagerung:**

Blut wird durch Venenpunktion entnommen. Das Serum wird nach der Gerinnung durch Zentrifugation getrennt. Plasma kann auch verwendet werden. Lipämische, hämolytische oder kontaminierte Proben sollten nicht verwendet werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen sollte vermieden werden. Wenn Proben für mehrere Assays verwendet werden sollen, aliquotieren Sie zunächst Proben und bleiben bei - 20°C.

Für Zellkulturüberstand - Falls erforderlich, vor der Analyse zur Entfernung von Rückständen zentrifugieren. Proben können bei -20°C oder -80°C gelagert werden. Vermeiden Sie wiederholte Frost-Tau-Zyklen.

#### **Vorbereitung vor dem Gebrauch:**

Lassen Sie die Proben vor dem Test Raumtemperatur erreichen. Passen Sie vorsichtig auf Patientenproben auf, um Homogenität zu gewährleisten.

Test Probenvorbereitung - Die Proben müssen 1:500 bis 1: 1000 (v/v) verdünnt werden, z. für 1:500 (1 µl Probe + 499 µl Probenverdünnung) vor dem Test. Die Proben können bis zu drei Tage bei 2 - 8°C aufbewahrt werden. Langzeitlagerung benötigt -20°C.

#### **Vorbereitung der Reagenzien (alle Reagenzien sollten unmittelbar vor Gebrauch verdünnt werden):**

1. Beschriften Sie Aliquote, die mit dem Kit-Chargen-Nr. Und dem Verfallsdatum hergestellt wurden, und lagern Sie sie unter den angegebenen Bedingungen.
2. Bringen Sie alle Reagenzien vor der Verwendung auf Raumtemperatur.
3. Waschpuffer (1X) herzustellen; verdünne 50 ml 20X Waschpuffer in 950 ml entionisiertem Wasser.

#### **Verfahrenshinweise:**

1. Um eine gute Assay-Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit zu erreichen, ist ein richtiges Waschen der Platten, um überschüssige nicht umgesetzte Reagenzien zu entfernen, wesentlich.
2. Der High-Dose-Hook-Effekt kann in Proben mit sehr hohen Konzentrationen von Daratumumab beobachtet werden. Der High-Dose-Hook-Effekt beruht auf einem Antikörperüberschuss bei sehr hohen Daratumumab-Konzentrationen in der Probe. Der High-Dose-Hook-Effekt tritt am ehesten bei Proben zu Beginn des Reinigungsprozesses auf. Wenn Hook-Effekt möglich ist, sollten die zu untersuchenden Proben mit einem kompatiblen Verdünnungsmittel verdünnt werden. Wenn also die Daratumumab-Konzentration der unverdünnten Probe geringer ist als die der verdünnten Probe, kann dies auf den Hook-Effekt hinweisen.
3. Vermeiden Sie die Untersuchung von Proben, die Natriumazid ( $\text{NaN}_3$ ) enthalten, da dies die HRP-Aktivität zerstören könnte, was zu einer Unterschätzung der Daratumumab-Menge führt.
4. Es wird empfohlen, alle Standards und Proben doppelt zu testen.
5. Pflegen Sie für alle Schritte eine sich wiederholende Timing-Sequenz von gut bis gut, um sicherzustellen, dass die Inkubationszeiten für jede Vertiefung gleich sind.

6. Wenn das Substrat vor der Verwendung eine deutliche blaue Farbe aufweist, ist es möglicherweise kontaminiert und die Verwendung eines solchen Substrats kann zu einer Beeinträchtigung der Empfindlichkeit des Assays führen.
7. Die Platten sollten innerhalb von 30 Minuten nach Zugabe der Stopplösung gelesen werden.
8. Erstellen Sie eine Arbeitsliste, um den Speicherort von Standards und Proben zu identifizieren.

**Testverfahren:**

1. Es wird dringend empfohlen, alle Kontrollen und Proben in Duplikaten oder Triplikaten auszuführen. Eine Standardkurve ist für jeden Test erforderlich. Alle Schritte müssen bei 37°C durchgeführt werden.
2. Pipettieren Sie **50 µl Assay Diluent** in jede Vertiefung.
3. **100 µl Standards** oder **Proben** in die entsprechenden Vertiefungen geben.
4. Decken Sie die Platte ab und inkubieren Sie für 60 Minuten bei 37°C.
5. Saugen und waschen Sie die Platte 4-mal mit **Waschpuffer (1X)** und tupfen Sie den Restpuffer ab, indem Sie die Platte mit der Oberseite nach unten auf saugfähiges Papier klopfen. Wischen Sie jegliche Flüssigkeit von der Unterseite der Mikrotitervertiefungen ab, da Rückstände den Leseschritt beeinträchtigen können.
6. Ohne Verzögerung in der gleichen Reihenfolge **50 µl Anti-Daratumumab: HRP-Konjugat** in jede Vertiefung pipettieren.
7. Decken Sie die Platte ab und inkubieren Sie für 60 Minuten bei 37°C.
8. Saugen und waschen Sie die Platte 4 Mal mit **Waschpuffer (1X)** und tupfen Sie den Restpuffer ab, indem Sie die Platte mit der Oberseite nach unten auf saugfähiges Papier klopfen. Wischen Sie jegliche Flüssigkeit von der Unterseite der Mikrotitervertiefungen ab, da Rückstände den Leseschritt beeinträchtigen können.
9. **100 µl TMB-Substrat** in jede Vertiefung geben.
10. Inkubiere die Platte 30 Minuten bei 37°C im Dunkeln. NICHT SCHÜTTELN, da dies zu höheren Hintergründen und schlechterer Präzision führen kann. Positive Vertiefungen sollten bläulich sein.
11. Pipettieren Sie **100 µl Stopplösung**. Die Wells sollten sich von blau nach gelb verfärbten.
12. Lesen Sie die Extinktion bei 450 nm mit einem Mikroplattenleser ab.

**Berechnung der Ergebnisse:**

Bestimmen Sie die mittlere Extinktion für jeden Satz von doppelten oder dreifachen Standards und Proben. Unter Verwendung von Semi-Log-Papier wird der Durchschnittswert (Extinktion 450 nm) jedes Standards auf der Y-Achse gegen die entsprechende Konzentration der Standards auf der X-Achse aufgetragen. Zeichne die beste Fitkurve durch die Standardpunkte. Um die unbekannten Daratumumab-Konzentrationen zu bestimmen, ermitteln Sie den Mittelwert der mittleren Absorption des Unbekannten auf der Y-Achse und zeichnen Sie eine horizontale Linie zur Standardkurve. Zeichnen Sie am Schnittpunkt eine vertikale Linie zur X-Achse und lesen Sie die Daratumumab-Konzentration. Wenn die Proben verdünnt wurden, multiplizieren Sie sie mit dem entsprechenden Verdünnungsfaktor. Software, die in der Lage ist, eine kubische Spline-Kurvenanpassung zu erzeugen, wird am besten für automatisierte Ergebnisse empfohlen.

**Hinweis:**

Es wird empfohlen, den Test in folgenden Fällen mit einem anderen Verdünnungsfaktor zu wiederholen:

- Wenn der Extinktionswert der Probe unter dem ersten Standard liegt.
- Wenn der Absorptionswert gleich oder höher als der Standard von 160 ng/ml ist.

**Qualitätskontrolle:**

Es wird empfohlen, für jeden Labortest geeignete Qualitätskontrollproben in jedem Lauf zu verwenden, um sicherzustellen, dass alle Reagenzien und Verfahren korrekt sind.

**Leistungsmerkmale des Kits:**

Dieses Kit wurde gemäß den EMA / FDA-Richtlinien gemäß dem ICH-Code für die Harmonisierung biologischer Assays validiert.

#### **Empfindlichkeit:**

**Nachweisgrenze:** Es ist definiert als die niedrigste nachweisbare Konzentration, die einem Signal von Mittelwert von '0' Standard plus 2 \* SD entspricht.

10 Replikate von "0" -Standards wurden ausgewertet und die LOD wurde als weniger als 0,2 µg/ml gefunden

#### **Linearität:**

Die im Kit enthaltenen Standards werden zur Messung des Linearitätsbereichs von Daratumumab in der Matrix verwendet.

#### **Präzision:**

Die Präzision ist definiert als der prozentuale Variationskoeffizient (% CV), dh die Standardabweichung dividiert durch den Mittelwert und multipliziert mit 100. Die Assay-Präzision wurde mit zwei Intra- (n = 5 Assays) und Inter-Assay-Reproduzierbarkeit (n = 5 Assays) bestimmt Pools mit niedrigen (0,2 µg/ml), mittleren (5 µg/ml) und hohen (100 µg/ml) Konzentrationen. Während die tatsächliche Genauigkeit von Labor zu Labor und Techniker zu Techniker variieren kann, wird empfohlen, dass alle Bediener eine Genauigkeit erreichen, die unter diesen Designzielen liegt, bevor Ergebnisse gemeldet werden.

Pool	Intra Assay %CV	Inter Assay %CV
Niedrig	<10%	<10%
Mittel	<5%	<5%
Hoch	<5%	<5%

#### **Einschränkungen der Methode**

Gesunde Personen sollten vom Daratumumab negativ getestet werden. Jede klinische Diagnose sollte nicht allein auf den Ergebnissen von In-vitro-Diagnosemethoden basieren. Ärzten wird empfohlen, alle klinischen und labordiagnostischen Befunde zu berücksichtigen, um eine Diagnose zu stellen.

#### **Sicherheitsvorkehrungen:**

- **Dieses Kit ist nur für In-vitro-Anwendungen vorgesehen.** Befolgen Sie die Arbeitsanweisungen sorgfältig.
- Die im Kit angegebenen Verfallsdaten sind zu beachten. Gleiches gilt für die für Reagenzien angegebene Stabilität.
- Verwenden oder mischen Sie keine Reagenzien aus verschiedenen Chargen.
- Verwenden Sie keine Reagenzien von anderen Herstellern.
- Vermeiden Sie eine Zeitverschiebung beim Pipettieren von Reagenzien.
- Alle Reagenzien sollten in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
- Einige der Reagenzien enthalten eine kleine Menge Natriumazid (<0,1% w/w) als Konservierungsmittel. Sie dürfen nicht verschluckt oder mit Haut oder Schleimhäuten in Berührung kommen.
- Ausgangsmaterialien, die aus menschlichen Körperflüssigkeiten stammen oder Organe, die bei der Herstellung dieses Kits verwendet wurden, wurden getestet und als negativ für HBsAg und HIV sowie für HCV-Antikörper befunden. Kein bekannter Test garantiert jedoch die Abwesenheit solcher viralen Mittel. Behandeln Sie daher alle Komponenten und alle Patientenproben als potenziell gefährlich.
- Da das Kit potenziell gefährliche Materialien enthält, sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden
  - Beim Umgang mit dem Kit-Material nicht rauchen, essen oder trinken
  - Verwenden Sie immer Schutzhandschuhe
  - Pipettieren Sie das Material niemals mit dem Mund
  - Verschüttetes Material sofort abwischen und die betroffene Oberfläche gründlich mit einem Dekontaminationsmittel waschen.
- In jedem Fall sollte GLP mit allen allgemeinen und individuellen Vorschriften zur Verwendung dieses Kits angewendet werden.



**Verweise:**

Pharmakokinetik von Daratumumab Nach intravenöser Infusion im verwandten oder refraktorischen Multiplen Myelom nach Prior Proteasome Inhibitor und Immunmodulatory Drug Treatment ... Pamela L. Clemens, Xiaoyu Yan, Henk M. Lokhorst, Sagar Lonial, Nedjad Losic, Imran Khan, Richard Jansson, Tahamtan Ahmadi, Kristen Lantz, Honghui Zhou,<sup>1</sup> Thomas Puchalski, und Xu Steven Xu ... Clin Pharmacokinet ... 2017 ... Springer

Daratumumab, ein CD38 Monoclonal Antibody bei Patienten mit Multiple Myelom-Daten aus einer Dose-Eskalationsphase I/I/II-Studie ... Torben Plesner, Henk Lokhorst, Peter Gimsing, Hareth Nahi, Steen Lisby und Paul G. Richardson ... Blut... 2012 ... Die Gesellschaft für Hämatologie

Daratumumab, ein neuartiger Therapeutischer Mensch CD38 Monoklonal Antibody, induziert das Töten von multiplem Myelom und anderen hämatologischen Tumoren ... Michel de Weers, Yu-Tzu Tai, Michael S. van der Veer, Joost M. Bakker, Tom Vink, Daniëlle C. H. Jacobs, Lukas A. Oomen, Matthias Peipp, Thomas Valerius, Jerry W. Slootstra, Tuna Mutis, Wim K. Bleeker, Kenneth C. Anderson, Henk M. Lokhorst, Jan G. J. van W. H. I. Parren ... J Immunol ... 2011 ... American Association of Immunologists

Daratumumab erschöpft CD38+ Immunregulationszellen, fördert die T-Zell-Erweiterung und verzerrt das T-Zell-Repertoire im Multiplen Myelom.

Jakub Krejcik, Tineke Casneuf, Inger S. Nijhof, Bie Verbist, Jaime Bald, Torben Plesner, Khaja Syed, Kevin Liu, Niels W. C. J. van de Donk, Brendan M. Weiss, Tahamtan Ahmadi, Henk M. Lokhorst, Tuna Mutis und A. Kate Sasser ... Blut... 2016 ... Die Gesellschaft für Hämatologie

Direkt im Vitro-Vergleich von Daratumumab mit den Leianalogen der CD38-Analoge MOR03087, SAR650984 und Ab79  
Jeroen Lammerts van Bueren, Danielle Jakobs, Niels Kaldenhoven, Marcel Roza, Sanne Hiddingh, Joyce Meesters, Marleen Voorhorst, Elke Gresnigt, Luus Wiegman, Antonio Ortiz Buijsse, Grietje Andringa, Marije B. Overdijk, Parul Doshi, Kate Sasser, Michel de Weers Und Paul W.H.I. Parren ... Blut... 2014 ... Die Gesellschaft für Hämatologie


Daratumumab für die Behandlung von Multiplen Myelom ... Touzeau C, Moreau P ... Experte Opin Biol Ther....2017 ... Taylor & Francis

## SCHEMATISCHES TESTVERFAHREN

1. Entfernen Sie alle Komponenten, 30 Minuten vor Zugabe in die Testplatte.



2. Vermeiden Sie wiederholtes Abkühlen und Auftauen der Komponenten, da es zu einem Aktivitätsverlust kommen kann und dies die Ergebnisse beeinträchtigen kann.

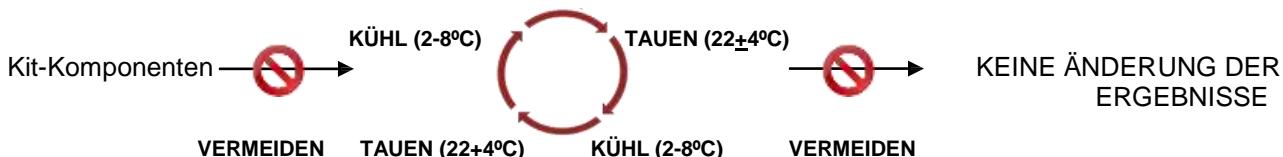


3. Pipettieren Sie **50 µl Testverdünnungsmittel** in jede Vertiefung.



4. **100 µl Standards / Proben** in die entsprechenden Vertiefungen pipettieren.



5. Decken Sie die Platte und inkubieren Sie für **60 min** bei 37°C.




6. Saugen und waschen Sie die Wells 4 mal mit **Wash Buffer (1X)**.



7. **50 µl Anti Daratumumab: HRP** in jede Vertiefung pipettieren



8. Decken Sie die Platte und inkubieren Sie für **60 min** bei 37°C.



9. Saugen und waschen Sie die Wells 4 mal mit **Wash Buffer (1X)**



10. **100 µl TMB-Substrat** in jede Vertiefung pipettieren



11. Decken Sie die Platte und inkubieren Sie für **30 min** bei 37°C.



12. **100 µl Stopplösung** in jede Vertiefung pipettieren.



13. Die Extinktion bei 450 nm mit einem Mikroplattenleser innerhalb **30 min** der Stopreaktion ablesen.



**Typisches Beispiel für eine Arbeitsliste**

Well #	Inhalt	Extinktion bei 450 nm	Mittlere Extinktion	ng/ml Daratumumab- Äquivalent
1A 2A	Nullstd Nullstd			
1B 2B	0,2 µg/ml 0,2 µg/ml			
1C 2C	0,5 µg/ml 0,5 µg/ml			
1D 2D	2 µg/ml 2 µg/ml			
1E 2E	5 µg/ml 5 µg/ml			
1F 2F	20 µg/ml 20 µg/ml			
1G 2G	50 µg/ml 50 µg/ml			
1H 2H	100 µg/ml 100 µg/ml			
3A 4A	Probe			
3B 4B	Probe			

**EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

Krishgen Biosystems übernimmt keine Garantie für Schäden oder Mängel, die sich aus dem Versand oder der Handhabung oder aus einem Unfall oder einer unsachgemäßen oder abnormalen Verwendung der Produkte ergeben; gegen Defekte in Produkten oder Komponenten, die nicht von Krishgen Biosystems hergestellt wurden, oder gegen Schäden, die durch solche von Krishgen Biosystems hergestellten Produkte oder Komponenten entstehen. Krishgen Biosystems gibt dem Kunden die Garantie, die er (falls vorhanden) vom Hersteller solcher nicht von Krishgen hergestellten Produkte oder Komponenten erhalten hat. Diese Garantie gilt auch nicht für Produkte, an denen Änderungen oder Modifikationen vorgenommen oder versucht wurden, die nicht von Krishgen Biosystems schriftlich genehmigt wurden.

DIESE GARANTIE IST EXKLUSIV. Die einzige und ausschließliche Verpflichtung von Krishgen Biosystems besteht darin, die fehlerhaften Produkte in der oben beschriebenen Art und Weise zu reparieren oder zu ersetzen. Krishgen Biosystems hat keine weiteren Verpflichtungen in Bezug auf die Produkte oder Teile davon, sei es auf Vertragsbasis, unerlaubter Handlung und verschuldensunabhängige Haftung oder anderweitig. In keinem Fall, unabhängig davon, ob aufgrund dieser beschränkten Garantie oder anderweitig, haftet Krishgen Biosystems für zufällige, spezielle oder Folgeschäden.

Diese beschränkte Garantie enthält die gesamte Verpflichtung von Krishgen Biosystems in Bezug auf die Produkte. Wenn ein Teil dieser eingeschränkten Garantie für ungültig oder rechtswidrig erklärt wird, bleibt der Rest in voller Kraft und Wirkung.

Krishgen Biosystems. 2018

**DANKE FÜR DAS KRISHGEN PRODUKT!**

# KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA

**REF** : KBI1028

Ver 2.0

**IVD**

Inmunoensayo enzimático para la determinación cuantitativa de Daratumumab en suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular

<b>IVD</b>	Para uso diagnóstico in vitro	<b>REF</b>	Número de catálogo
	Almacenado en	<b>LOT</b>	Código de lote
	Fabricado por		Riesgo biológico
	Fecha de caducidad		Consultar las instrucciones de funcionamiento

Sólo para uso diagnóstico in vitro. La compra no incluye ni tiene el derecho de revender o transferir este producto como un producto independiente o como un componente de otro producto. Cualquier uso de este producto que no sea el uso permitido sin la autorización expresa por escrito de KRISHGEN BioSystems está estrictamente prohibido.



**REF** KBI1028

96 tests



**KRISHGEN BioSystems**

Unit Nos#318/319, Shah & Nahar,  
Off Dr E Moses Road, Worli, Mumbai 400018.  
Tel: 91 (22) 49198700 | Email: sales@krishgen.com  
<http://www.krishgen.com>



MDSS GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

**Introducción:**


Daratumumab (nombre comercial Darzalex) es un medicamento contra el cáncer. Se une a CD38, que las células del mieloma múltiple sobreexpresan. Daratumumab fue desarrollado originalmente por Genmab, pero ahora está siendo desarrollado conjuntamente por Genmab junto con la subsidiaria de Johnson & Johnson Janssen Biotech, que adquirió los derechos de comercialización a nivel mundial del medicamento de Genmab. Daratumumab recibió un estado de tratamiento farmacológico innovador en 2013 para el mieloma múltiple. Se le otorgó el estatus de fármaco huérfano para el mieloma múltiple, el linfoma difuso de células B grandes, el linfoma folicular y el linfoma de células del manto.

**Uso previsto:**

El KRIBIOLISA™ Daratumumab ELISA se utiliza como herramienta analítica para la determinación cuantitativa de Daratumumab en suero, plasma y sobrenadante de cultivo celular.

**Principio:**

El método emplea la técnica de inmunoensayo enzimático cuantitativo sándwich. Los anticuerpos contra Daratumumab se recubren previamente en micropocillos. Las muestras y los estándares se pipetean en micropocillos y el Daratumumab humano presente en la muestra está unido por el anticuerpo de captura. Luego, se pipetea y se incuba un anticuerpo antiDaratumumab conjugado con HRP (peroxidasa de rábano picante). Despues de lavar los micropocillos para eliminar cualquier enlace no específico, la solución de sustrato lista para usar (TMB) se agrega a los micropocillos y el color se desarrolla proporcionalmente a la cantidad de Daratumumab en la muestra. El desarrollo del color se detiene luego mediante la adición de una solución de parada. La absorbancia se mide a 450 nm.

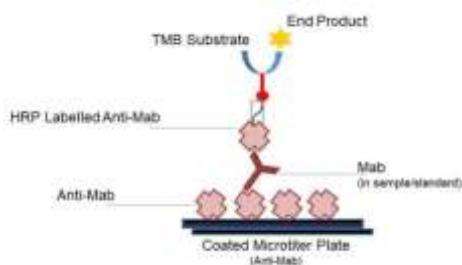**Materiales provistos:**

1. Placa de microtitulación recubierta con antiDaratumumab (12x8 pocillos) - 1 no
2. Daratumumab Standard, (0.1 ml / vial) - 0, 0.2, 0.5, 2, 5, 20, 50 y 100 µg/ml
3. AntiDaratumumab: conjugado HRP - 6 ml
4. Diluyente de ensayo - 6 ml
5. Diluyente de muestra - 50 ml
6. Tampón de lavado (20X) - 25 ml
7. Sustrato TMB - 12 ml
8. Solución de parada - 12 ml
9. Manual de instrucciones

**Materiales a ser provistos por el usuario final:**

1. Lector de placas de microtitulación capaz de medir la absorbancia a 450 nm.
2. Pipetas ajustables y pipeteador multicanal para medir volúmenes que van desde 25 µl hasta 1000 µl
3. Agua desionizada (DI)
4. Lavado de botellas o lavadoras automáticas de microplacas.
5. Papel o software para el análisis de datos de semi-registro.
6. temporizador
7. Papel absorbente

**Manipulación / Almacenamiento:**

1. Todos los reactivos deben almacenarse entre 2°C y 8°C para su estabilidad.
2. Todos los reactivos y soluciones de lavado deben usarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de fabricación.
3. Antes de usar, lleve todos los componentes a temperatura ambiente (18-25°C). Al finalizar el ensayo, asegúrese de que todos los componentes del kit regresen a las condiciones de almacenamiento apropiadas.
4. El sustrato es sensible a la luz y debe protegerse de la luz solar directa o de las fuentes UV.

#### **Advertencias de peligro para la salud:**

1. Los reactivos que contienen conservantes pueden ser dañinos si se ingieren, se inhalan o se absorben a través de la piel.
2. Para uso diagnóstico in vitro solamente.



#### **Preparación y almacenamiento de muestras:**

La sangre se toma por venopunción. El suero se separa después de la coagulación por centrifugación. También se puede usar plasma. No se deben analizar muestras tubémicas, hemolíticas o contaminadas. Debe evitarse la congelación y descongelación repetidas. Si las muestras se van a utilizar para varios ensayos, alicueque inicialmente las muestras y manténgalas a -20°C.

Para el sobrenadante de cultivo celular: si es necesario, centrifugue para eliminar los residuos antes del análisis. Las muestras se pueden almacenar a -20°C o -80°C. Evite los ciclos repetidos de congelación y descongelación.

#### **Preparación antes del uso:**

Permita que las muestras alcancen la temperatura ambiente antes del ensayo. Tenga cuidado de agitar las muestras del paciente con suavidad para garantizar la homogeneidad.

Prueba Preparación de la muestra: las muestras deben diluirse de 1:500 a 1:1000 (v/v), p. para 1:500 (1 µl de muestra + 499 µl de diluyente de muestra) antes del ensayo. Las muestras pueden conservarse a 2 - 8°C durante hasta tres días. El almacenamiento a largo plazo requiere -20°C.

#### **Preparación de los reactivos (todos los reactivos deben diluirse inmediatamente antes de su uso):**

1. Etiquete todas las alícuotas hechas con el lote del lote y la fecha de vencimiento y guárdelas en las condiciones apropiadas mencionadas.
2. Lleve todos los reactivos a temperatura ambiente antes de usarlos.
3. Para hacer un tampón de lavado (1X); diluir 50 ml de tampón de lavado 20X en 950 ml de agua DI.

#### **Notas de procedimiento:**

1. Para lograr una buena reproducibilidad y sensibilidad del ensayo, es esencial el lavado adecuado de las placas para eliminar el exceso de reactivos sin reaccionar.
2. El efecto de gancho de alta dosis se puede observar en muestras con concentraciones muy altas de Daratumumab. El efecto de gancho de alta dosis se debe al exceso de anticuerpos para concentraciones muy altas de Daratumumab presente en la muestra. El efecto Gancho de alta dosis es más probable que se encuentre en las muestras al principio del proceso de purificación. Si es posible el efecto de gancho, las muestras a analizar deben diluirse con un diluyente compatible. Por lo tanto, si la concentración de Daratumumab de la muestra no diluida es menor que la muestra diluida, esto puede ser indicativo del efecto gancho.
3. Evite el análisis de muestras que contengan azida sódica ( $\text{NaN}_3$ ), ya que podría destruir la actividad de HRP, lo que resultaría en una subestimación de la cantidad de Daratumumab.
4. Se recomienda que todas las normas y muestras se analicen por duplicado.
5. Mantenga una secuencia de tiempo repetitiva de bien a bien para todos los pasos para asegurarse de que los tiempos de incubación sean iguales para cada pozo.
6. Si el sustrato tiene un color azul distinto antes de su uso, puede haber estado contaminado y el uso de dicho sustrato puede comprometer la sensibilidad del ensayo.
7. Las placas deben leerse dentro de los 30 minutos posteriores a la adición de la solución de parada.
8. Haga una lista de trabajo para identificar la ubicación de los estándares y las muestras.

**Procedimiento de ensayo:**

1. Se recomienda encarecidamente que todos los controles y muestras se ejecuten por duplicado o triplicado. Se requiere una curva estándar para cada ensayo. Todos los pasos deben realizarse a 37°C.
2. Pipetee **50 µl de diluyente** de ensayo en cada pocillo.
3. Agregue **100 µl de estándares o muestras** en los pocillos respectivos.
4. Cubra la placa e incube durante 60 minutos a 37°C.
5. Aspire y lave la placa 4 veces con **tampón de lavado (1X)** y borre el tampón residual golpeando firmemente la placa boca abajo sobre papel absorbente. Limpie cualquier líquido del fondo fuera de los pocillos de microtitulación, ya que cualquier residuo puede interferir en el paso de lectura.
6. Pipetee sin demora en el mismo orden **50 µl de Anti-Daratumumab: HRP Conjugado** en cada pocillo.
7. Cubra la placa e incube durante 60 minutos a 37°C.
8. Aspire y lave la placa 4 veces con **tampón de lavado (1X)** y borre el tampón residual golpeando firmemente la placa boca abajo sobre papel absorbente. Limpie cualquier líquido del fondo fuera de los pocillos de microtitulación, ya que cualquier residuo puede interferir en el paso de lectura.
9. Agregue **100 µl de Sustrato TMB** en cada pozo.
10. Incubar la placa a 37°C durante 30 minutos en la oscuridad. NO LO AGITE o, de lo contrario, se pueden producir fondos más altos y peor precisión. Los pozos positivos deben volverse de color azulado.
11. Pipetear **100 µl de Solución de Paro**. Los pozos deben cambiar de azul a amarillo.
12. Lea la absorbancia a 450 nm con un lector de microplacas.

**Calculo de resultados:**

Determine la Absorción media para cada conjunto de muestras y estándares duplicados o triplicados. Usando el papel gráfico Semi-Log, trace el valor promedio (absorbancia 450nm) de cada estándar en el eje Y frente a la concentración correspondiente de los estándares en el eje X. Dibuja la curva de mejor ajuste a través de los puntos estándar. Para determinar las concentraciones desconocidas de Daratumumab, encuentre el valor de Absorción media de la incógnita en el eje Y y trace una línea horizontal hacia la curva estándar. En el punto de intersección, dibuje una línea vertical hacia el eje X y lea la Concentración de Daratumumab. Si las muestras se diluyeron, multiplique por el factor de dilución apropiado. El software que puede generar un ajuste de curva de spline cúbico se recomienda para resultados automatizados.

**Nota:**

Se recomienda repetir el ensayo a un factor de dilución diferente en los siguientes casos:

- Si el valor de absorbancia de la muestra está por debajo del primer estándar.
- Si el valor de absorbancia es equivalente o superior al estándar de 100 µg/ml.

**Control de calidad:**

Se recomienda que, para cada ensayo de laboratorio, se usen muestras de control de calidad apropiadas en cada ejecución para garantizar que todos los reactivos y procedimientos sean correctos.

**Características de rendimiento del kit:**

Este kit ha sido validado según las pautas de EMA / FDA en línea con el Código ICH para la Armonización de Ensayos Biológicos.

**Sensibilidad:**

**Límite de detección:** Se define como la concentración detectable más baja correspondiente a una señal de la media de "0" estándar más 2 \* SD.

Se evaluaron 10 réplicas de estándares '0' y se encontró que el LOD era inferior a 0.2 µg/ml

#### Linealidad:

Los estándares proporcionados en el kit se utilizarán para medir el rango de linealidad del Daratumumab presente en la matriz.

#### Precisión:

La precisión se define como el porcentaje de coeficiente de variación (% CV), es decir, la desviación estándar dividida por la media y multiplicada por 100. La precisión del ensayo se determinó mediante la reproducibilidad intra ( $n = 5$ ) y entre ensayos ( $n = 5$ ) en dos piscinas con concentraciones bajas (0.2 µg/ml), medias (5 µg/ml) y altas (100 µg/ml). Si bien la precisión real puede variar de un laboratorio a otro y de un técnico a otro, se recomienda que todos los operadores alcancen una precisión por debajo de estos objetivos de diseño antes de informar los resultados.

Resultado	Ensayo Intra %CV	Ensayo Inter %CV
Bajo	<10%	<10%
Medio	<5%	<5%
Alto	<5%	<5%

#### Limitaciones del método

Los individuos sanos deben tener un resultado negativo con el Daratumumab. Cualquier diagnóstico clínico no debe basarse solo en los resultados de los métodos de diagnóstico in vitro. Se sugiere a los médicos que consideren todos los hallazgos clínicos y de laboratorio posibles para establecer un diagnóstico.

#### Precauciones de seguridad:

- Este kit es solo para uso in vitro. Siga cuidadosamente las instrucciones de trabajo.
- Se deben respetar las fechas de caducidad indicadas en el kit. Lo mismo se refiere a la estabilidad indicada para los reactivos.
- No utilice ni mezcle reactivos de lotes diferentes.
- No utilice reactivos de otros fabricantes.
- Evite el cambio de tiempo durante el pipeteo de reactivos.
- Todos los reactivos deben mantenerse en el contenedor de envío original.
- Algunos de los reactivos contienen una pequeña cantidad de azida de sodio (<0.1% p/p) como conservante. No se deben tragar ni permitir que entren en contacto con la piel o la mucosa.
- Los materiales de origen derivados de los fluidos del cuerpo humano u órganos utilizados en la preparación de este kit se analizaron y se encontraron negativos para HBsAg y VIH, así como para anticuerpos contra el VHC. Sin embargo, ninguna prueba conocida garantiza la ausencia de tales agentes virales. Por lo tanto, manipule todos los componentes y todas las muestras de pacientes como si fueran potencialmente peligrosos.
- Dado que el kit contiene materiales potencialmente peligrosos, se deben observar las siguientes precauciones
  - No fume, coma o beba mientras manipula el material del kit.
  - Usar siempre guantes de protección.
  - Nunca pipetear el material con la boca.
  - Limpie los derrames rápidamente, lavando la superficie afectada a fondo con un descontaminante.
- En cualquier caso, el GLP debe aplicarse con todas las regulaciones generales e individuales para el uso de este kit.



#### Referencias:

Farmacocinética de la Daratumumab después de la infusión intravenosa en el mieloma múltiple recaído o refractario después del tratamiento anterior de la droga del inhibidor y del inmunomodulador del proteasoma... Pamela L. Clemens, Xiaoyu Yan, Henk M. Iokhorst, Sagar Lonial, Nedjad Losic, Imran Khan, Richard Jansson, Tahamtan Ahmadi, Kristen Lantz, Honghui Zhou, Thomas Puchalski, y Xu Steven Xu... Clin Pharmacokinet... 2017... Springer

Daratumumab, un anticuerpo monoclonal CD38 en pacientes con mieloma múltiple-datos de un estudio de la fase I/II de la dosificación escalada... Torben Plesner, Henk lokhorst, Peter Gimsing, Harith Nahi, Steen Lisby y Paul G. Richardson... Sangre... 2012... Sociedad Americana de Hematología

Daratumumab, un anticuerpo monoclonal CD38 humano terapéutico nuevo, induce la matanza del mieloma múltiple y de otros tumores hematológicos... Michel de Weers, Yu-Tzu Tai, Michael S. van der Veer, Joost M. Bakker, Tom Vink, Daniëlle c. h. Jacobs, Lukas A. Oomen, Matthias Peipp, Thomas Valerio, Jerry W. Slootstra, atún Mutis, Wim K. Bleeker, Kenneth C. Anderson, Henk M. lokhorst, Jan g. j. van de Winkel y Paul W. h. I. Parren... J... 2011... Asociación Americana de los inmunólogos

Daratumumab agota las células reguladoras CD38 + inmunes, promueve la extensión de la T-célula, y sesga el repertorio del T-cell en mieloma múltiple

Jakub Krejcik, Tineke Casneuf, Inger S. Nijhof, BIE Verbista, Jaime Bald, Torben Plesner, Khaja Syed, Kevin Liu, Niels w. c. j. van de Donk, Brendan M. Weiss, Tahamtan Ahmadi, Henk M. lokhorst, atún Mutis y A. Kate Sasser... Sangre... 2016... Sociedad Americana de Hematología

Comparación directa in vitro de Daratumumab con análogos sustitutos de los anticuerpos CD38 MOR03087, SAR650984 y Ab79  
Jeroen Lammerts van BUREN, Danielle Jakobs, Niels Kaldenhoven, Marcel roza, Sanne Hiddingh, Joyce Meesters, Marleen Voorhorst, Elke Gresnigt, Luus Wiegman, Antonio Ortiz Buijsse, Grietje Andringa, Marije B. sobredijk, Parul Doshi, Kate Sasser, Michel de Weers y Paul W.H.I. Parren... Sangre... 2014... Sociedad Americana de Hematología


Daratumumab para el tratamiento del mieloma múltiple... Touzeau C, Moreau P... Experto Opin Biol.... 2017... Taylor & Francis

## PROCEDIMIENTO DE ENSAYO ESQUEMATICO

- Retire todos los componentes, 30 minutos antes de agregarlos a la placa de ensayo.



- Evite el enfriamiento y descongelamiento repetido de los componentes ya que habrá una pérdida de actividad y esto puede afectar los resultados.

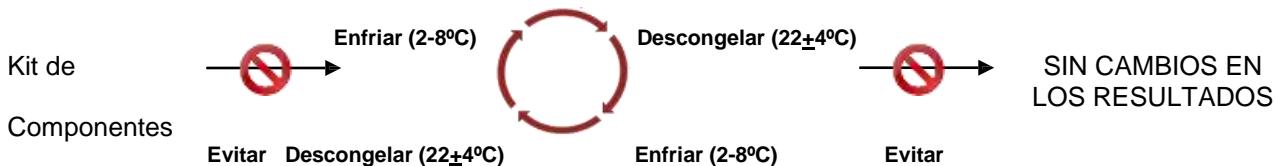

- Pipetear **50 µl de diluyente** de ensayo en cada pocillo.




Pipetear **50 µl de diluyente** de ensayo en cada pocillo.

- Pipetear **100 µl de estándares / muestras** en los pocillos respectivos.



Pipetear **100 µl de estándares / muestras** en los pocillos respectivos.

- Cubrir la placa e incubar a 37°C.



Cubrir la placa e incubar a 37°C.



- Aspire y lave los pocillos 4 veces con **tampón de lavado (1X)**.



Aspire y lave los pocillos 4 veces con **tampón de lavado (1X)**.

- Pipetea **50 µl de Anti Daratumumab: HRP** en cada pocillo.



Pipetea **50 µl de Anti Daratumumab: HRP** en cada pocillo.



- Cubrir la placa e incubar a 37°C.



Cubrir la placa e incubar a 37°C.

- Aspire y lave los pocillos 4 veces con **tampón de lavado (1X)**.



Aspire y lave los pocillos 4 veces con **tampón de lavado (1X)**.

- Pipetear **100 µl de sustrato TMB** en cada pozo.



Pipetear **100 µl de sustrato TMB** en cada pozo.



- Cubrir la placa e incubar a 37°C.



Cubrir la placa e incubar a 37°C.

- Pipetea **100 µl de solución de parada** en cada pocillo.



Pipetea **100 µl de solución de parada** en cada pocillo.



- Lea la absorbancia a 450 nm con un lector de microplacas dentro de la reacción de parada.



dentro de la reacción de parada.

**Ejemplo típico de una lista de trabajo**

Bien #	Contenido	Absorbancia a 450nm	Absorbancia media	ng/ml Daratumumab equivalente
1A 2A	cero std cero std			
1B 2B	0.2 µg/ml 0.2 µg/ml			
1C 2C	0.5 µg/ml 0.5 µg/ml			
1D 2D	2 µg/ml 2 µg/ml			
1E 2E	5 µg/ml 5 µg/ml			
1F 2F	20 µg/ml 20 µg/ml			
1G 2G	50 µg/ml 50 µg/ml			
1H 2H	100 µg/ml 100 µg/ml			
3A 4A	Muestra			
3B 4B	Muestra			

**GARANTÍA LIMITADA**

Krishgen Biosystems no garantiza los daños o defectos que surjan durante el envío o la manipulación, o por accidente o uso inapropiado o anormal de los Productos; contra defectos en productos o componentes no fabricados por Krishgen Biosystems, o contra daños que resulten de productos o componentes que no sean Krishgen Biosystems. Krishgen Biosystems transmite al cliente la garantía que recibió (si la hubiera) del fabricante de dichos productos o componentes no hechos por Krishgen. Esta garantía tampoco se aplica a los Productos en los cuales los cambios o modificaciones hayan sido realizados o intentados por personas distintas a las autorizadas por escrito por Krishgen Biosystems.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA. La única y exclusiva obligación de Krishgen Biosystems será reparar o reemplazar los Productos defectuosos en la forma y por el período mencionado anteriormente. Krishgen Biosystems no tendrá ninguna otra obligación con respecto a los Productos o cualquier parte de los mismos, ya sea por contrato, responsabilidad extracontractual y responsabilidad estricta o de otro tipo. Bajo ninguna circunstancia, ya sea que se basen en esta Garantía Limitada o de otra manera, Krishgen Biosystems será responsable por daños incidentales, especiales o consecuentes.

Esta Garantía Limitada establece la obligación total de Krishgen Biosystems con respecto a los Productos. Si se determina que alguna parte de esta Garantía Limitada es nula o ilegal, el resto permanecerá en pleno vigor y efecto.

Krishgen Biosystems. 2018

***¡GRACIAS POR EL USO DEL PRODUCTO KRISHGEN!***